

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



19007311001-11-B30

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:
Certificate No. RC20Z-DA005314

客户名称: 首都医科大学附属北京安定医院
Client
物品名称: 冰箱
Name of Item
型号/规格: FYL-YS100E
Model/Specification
物品编号: 030100543
Serial No.
制造单位: 福意联
Manufacturer
客户地址: 北京市西城区德胜门外安康胡同5号
Address of the Client
物品接收/校准日期: 2020-11-16/2020-11-16
Date of Receipt/Calibration



批准人
Approved by

核验员
Checked by

校准员
Calibrated by



签发日期 2020 年 11 月 16 日
Date of Issue Year Month Day

计量检定机构授权证书号:
Authorization Certificate No. (国)法计(2017)01007号

地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel): 400-090-0026
传真(Fax): 010-57521500
邮编(Post Code): 100029
电子信箱(E-mail): jly@bjil.cn



北京市计量检测科学研究院

北京市计量检测科学研院校准证书

Calibration Certificate of BIM

证书编号: RC20Z-DA005314
Certificate No.

北京市计量检测科学研究院是国家法定计量检定机构, 检定和校准资格获得国家市场监督管理总局授
权。
Beijing Institute of Metrology(BIM) is a National Legal Metrological Verification Institution, which is authorized to
conduct verification and calibration services by SAMR.

校准依据 Calibration Reference	JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范				
校准地点 Calibration Location	北京市西城区德胜门外安康胡同5号				
环境条件 Environmental conditions	温度(°C) temperature(°C)	20.2	相对湿度(%) Relative humidity(%)	30	其它 Other

本次校准所使用的主要计量标准器 Measurement Standards for Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/MPE	证书编号/溯源单位 Certificate No./Trace to	有效期至 Date of Expiry
温度巡检仪	(-80~300) °C	$U=0.03^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	RA20S- AF001517/北京 计量院	2022-03-25
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- 本证书以中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。
The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.
- 本证书未加盖校准专用章无效
The certificate is invalid without the calibration seal of BIM.
- 被校物品修理后, 应立即重新校准。
Recalibrate the item as soon as it is repaired.
- 在使用过程中, 如对被校物品的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
Recalibrate the item if there are any doubts about its performance.
- 根据顾客的要求, 复校时间间隔为(/)个月。
According to requirements of the client, the calibration interval should be (/) months.

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.



北京市计量检测科学研究院校准证书
Calibration Certificate of BIM

证书编号: RC20Z-DA005314
Certificate No.

第 3 页共 3 页
Page 3 of 3

校准结果
Results of Calibration

1. 校准结果 (满载):


设定温度 (°C)	2~8
实测温度 (°C)	6.0
温度波动度 (°C)	± 0.4
温度均匀度 (°C)	4.7

各于球分布点对应温度值(共9点):

设定温度 (°C)	分布点								
	A	B	C	D	O	E	F	G	H
2~8	实测值 (°C)								
	2.5	3.0	3.8	2.6	6.0	6.5	7.2	6.3	6.5

测量结果的扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)

2. 校准点布放图:

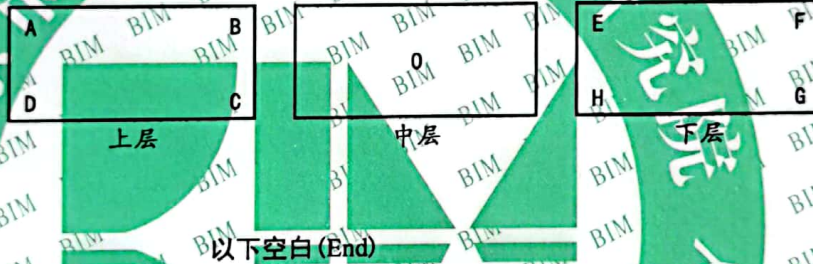

证书骑缝专用章(1)

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.



扫描全能王 创建